

FR IT ES PT DK
PL CZ GR CN JP


5 | 2018-08

2. Download the Tacx Uno app for free from the App store or Google play.
- 3.

leet is | DE Prüfen Sie, Vérifiez que tout se ezione contenga tutto | ifique se está tudo na en | NO Du må en | SE Kontrollera att osat ovat pakkauksessa | pakowaniu | CZ εάν περιέχονται όλα τα 모두 들어 있는지齐全 | JP すべての部品。

NL Plaats de batterij in de hartslag monitor | **DE** Legen Sie die Batterie in die Herzfrequenzüberwachung ein | **FR** Placez la pile dans le moniteur de fréquence cardiaque | **IT** Inserire la batteria nel monitor per la frequenza cardiaca | **ES** Coloque la batería en el monitor de frecuencia cardíaca | **PT** Coloque a pilha no monitor de frequência cardíaca | **DK** Sæt batteriet i hjertefrekvensmonitoren | **NO** Sett batteriet i pulsmåleren | **SE** Sätt i batteriet i pulsmätaren | **FI** Aseta paristo sykemittariin | **PL** Umieść baterię w monitorze pracy serca | **CZ** Vložte do monitoru tepové frekvence baterii | **GR** Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στο καρδιοσυγχρόνετρο | **KR** 앱스토어 또는 구글 플레이에서 무료로 택스 우노 (Taco Uno) 앱을 다운로드합니다 | **CN** 將蓄電池裝入心率監視器 | **JP** 心拍数モニターに電池を入れます。

NL Plaats de batterij in de sensor, deze wordt direct geactiveerd inactief is kun je hem activeren door te schudden | **DE** Clipsen Sie die Herzfrequenzüberwachung an Ihrem Brustgurt fest | **FR** Clipsez le moniteur de fréquence cardiaque sur la sangle de poitrine | **IT** Aggiungete il monitor per la frequenza cardiaca alla fascia sul petto | **ES** Encártelos en el monitor de frecuencia cardíaca en la banda del pecho | **PT** Fixe o monitor de frequência cardíaca à cinta torácica | **DK** Klik din hjertefrekvensmonitoren på brystremmen | **NO** Fest pulsmåleren på brystbeltet | **SE** Snäppa pulsmätaren på bröstabandet | **FI** Napsauta sykemittari kiinni lähetin | **PL** Przypnij monitor pracy serca do pasa piersiowego | **CZ** Připevněte monitor tepové frekvence k hrudnímu popruhu | **GR** Κουμπώστε το καρδιοσυγχρόνετρο στη γύνη στήθους | **KR** 센서에 배터리를 넣습니다.

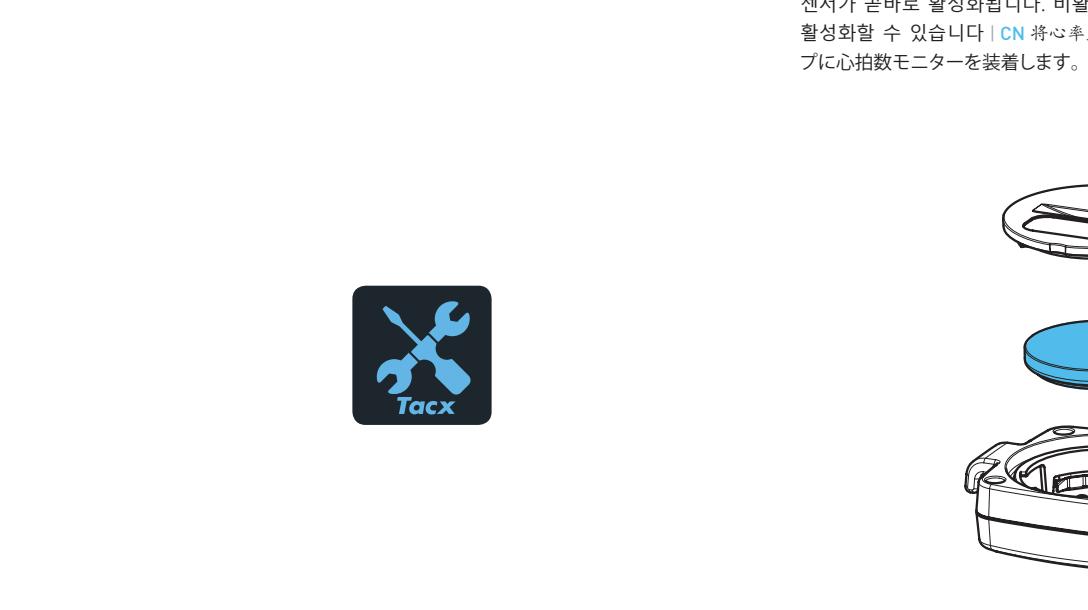

Open the app on your smartphone or tablet and connect the sensor to the application.

5. Assign the feature you wish to use with the sensor and set the requested values.

L Open de app op je smartphone of tablet en koppel de sensor aan de applicatie | **DE** Clipsen Sie die Herzfrequenzüberwachung an Ihrem Brustgurt fest | **FR** Clipez votre moniteur de fréquence cardiaque sur la sangle de poitrine | **IT** Agganciate il monitor per la frequenza cardiaca alla fascia sul petto | **ES** Encaje el monitor de frecuencia cardíaca en la banda del pecho | **PT** Fixe o monitor de frequência cardíaca à cinta torácica | **DK** Klik din hjertefrekvensmonitor på brystremmen | **NO** Fest pulsmåleren på bystbeltet | **SE** Snäpp fast pulsmätaren på bröstabandet | **FI** Napsauta sykemittari kiinni lähetinvyöhön | **PL** Przypnij monitor pracy serca do pasa piersiowego | **CZ** Připevněte monitor tepové frekvence k hrudnímu popruhu | **GR** Κουμπώστε το καρδιοσυχνόμετρο στην στήθους | **KR** 마트폰이나 태블릿에서 앱을 열고 센서를 앱에 연결합니다 | **CN** 将心監視器別到胸带上 | **JP** チェストストラップに心拍数モニターを装着します。

NL Stel de gewenste feature en waardes in voor de sensor | **DE** Clipsen Sie die Herzfrequenzüberwachung an Ihrem Brustgurt fest | **FR** Clipez votre moniteur de fréquence cardiaque sur la sangle de poitrine | **IT** Agganciate il monitor per la frequenza cardiaca alla fascia sul petto | **ES** Encaje el monitor de frecuencia cardíaca en la banda del pecho | **PT** Fixe o monitor de frequência cardíaca à cinta torácica | **DK** Klik din hjertefrekvensmonitor på brystremmen | **NO** Fest pulsmåleren på bystbeltet | **SE** Snäpp fast pulsmätaren på bröstabandet | **FI** Napsauta sykemittari kiinni lähetinvyöhön | **PL** Przypnij monitor pracy serca do pasa piersiowego | **CZ** Připevněte monitor tepové frekvence k hrudnímu popruhu | **GR** Κουμπώστε το καρδιοσυχνόμετρο στην στήθους | **KR** 센서와 함께 사용할 기능을 설정하고 요청된 값을 설정합니다 | **CN** 将心率监视器别到胸带上 | **JP** チェストストラップに心拍数モニターを装着します。

NL Monteer de sensor | **DE** Aangegeven positie van de sensor op de borstband | **FR** La position indiquée de la capteur sur la sangle de poitrine | **IT** Posizione indicata del sensore sulla fascia toracica | **ES** La posición indicada del sensor en la cinta del pecho | **PT** Posição do sensor na cinta torácica | **DK** Klik din pulsmåleren på bystbeltet | **NO** Fix pulsmåleren på brystbelten | **SE** Sätt in pulsmätaren på bröstabandet | **FI** Napsauta pulsmåleren på bröstabandet | **PL** Przypnij pulsmåleren do pasa piersiowego | **CZ** Připevněte pulsmáter na hrudním popruhu | **GR** Στηθωτίστε το πολυμέτρο στην στήθους | **KR** 센서와 함께 사용할 기능을 설정하고 요청된 값을 설정합니다 | **CN** 将心率监视器别到胸带上 | **JP** チェストストラップに心拍数モニターを装着します。






sensor on your bike with the fitting strap at the

7. Calibrate the sensor in the app.
Accelerate to your max speed.

8. Close the app. The sensor is now paired.

ected from the Tacx Uno

9. Connect the sensor to the device you wish to
Bluetooth or ANT.

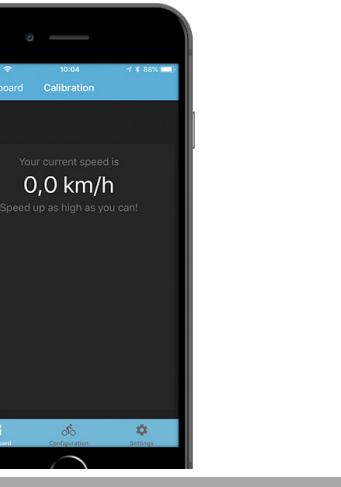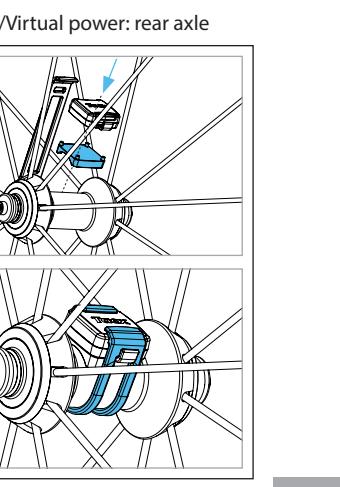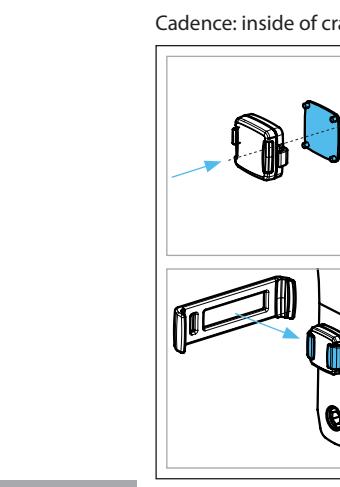

The LED indicates the following by blinking as described.

NL De LED geeft onderstaande aan door te knipperen zoals

weergegeven | DE De LED geeft onderstaande aan door te knipperen

zoals weergegeven | FR De LED geeft onderstaande aan door te

knipperen zoals weergegeven | IT De LED geeft onderstaande aan door te

te knipperen zoals weergegeven | ES De LED geeft onderstaande aan door te knipperen zoals weergegeven | PT De LED geeft onderstaande aan door te knipperen zoals weergegeven | DK De LED geeft

onderstaande aan door te knipperen zoals weergegeven | NO De LED geeft onderstaande aan door te knipperen zoals weergegeven | SE De

LED geeft onderstaande aan door te knipperen zoals weergegeven | FI

TDe LED geeft onderstaande aan door te knipperen zoals weergegeven |

CZ De LED geeft onderstaande aan door te knipperen zoals weergegeven |

| KR LED 점멸 상태에 대한 설명은 다음과 같습니다 | CN 檢查包装内物

品是否齐全 | JP すべての部品がパッケージに入っていることを確認してください

ださい。

Blinking time and frequency

Meaning

Waking up

Going to sleep

Updating firmware

Set to indoor

Set to speed

Set to cadence

Error

Battery low

DEUTSCH

Wartun

* Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.

Guía para la seguridad y el buen uso

No utilice este dispositivo cerca de equipo médico.

Tacx bv | Rijksstraatweg 48 | 2241BW | Wassenaar | the Netherlands



ENGLISH

Maintenance

- If necessary, wipe clean with a moist cloth.
- Please do not expose to chemicals.
- Keep away from fire and other heat sources.

The unit will activate when movement is detected. To maximize the transmitter battery lifetime, remove the battery when not used or transported for a longer period. There will be a blinking led when the sensor is activated.

Guide to safety and effective use

• Activate, connect and verify the sensor before and not during a ride or training.

• Do not use this device around medical equipment.

• Do not use this device in places where wireless devices are prohibited.

• The wireless signal could be disturbed under the environment of high voltage or strong magnetic fields.

• This device is not designed for industrial, commercial or medical use.

• Do not leave the sensor exposed in direct sunlight when not in use.

• Do not use sharp objects to replace the battery.

• Do not recharge the batteries.

• Do not damage or puncture the batteries.

• Replace the empty battery with the correct type.

• Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard.

• This product contains a coin battery. If the coin battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

• Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

• Do not damage or puncture the batteries.

• Replace the empty battery with the correct type.

• Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard.

• This product contains a coin battery. If the coin battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

• Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

General

• This manual was produced with care, however no rights can be derived. Tacx cannot accept liability for any errors in this manual or their consequences.

• Keep this manual and packaging for future reference.

NEDERLANDS

Onderhoud

• Als nodig, maak schoon met een vochtig doekje.

• Breng de monitor niet in contact met chemicaalën.

• Buiten bereik van vuur en andere warmte bronnen houden.

• De unit zal activeren wanneer beweging is gedetecteerd. Om de transmitter batterij levensduur te maximiseren, moet de batterij worden verwijderd als deze niet wordt gebruikt of voor een langere periode. Er zal een knippert LED zijn wanneer de sensor is geactiveerd.

Veilig en effectief gebruik

• Niet gebruiken in de buurt van medische apparatuur.

• Niet gebruiken op plaatsen waar draadloze apparatuur verboden is.

• Het signaal kan verstoord worden in de omgeving van hoogspannings- of magnetische velden.

• Dit apparaat is niet ontworpen voor industrieel en commercieel gebruik.

• De unit zal activeren wanneer beweging is gedetecteerd. Om de transmitter batterij levensduur te maximiseren, moet de batterij worden verwijderd als deze niet wordt gebruikt of voor een langere periode. Er zal een knippert LED zijn wanneer de sensor is geactiveerd.

• Do not leave the sensor exposed in direct sunlight when not in use.

• Do not use sharp objects to replace the battery.

• Do not recharge the batteries.

• Do not damage or puncture the batteries.

• Replace the empty battery with the correct type.

Algemeen

• Deze handleiding is zorgvuldig beschreven. Echter, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Tacx is niet aansprakelijk voor fouten in de handleiding noch de gevolgen van deze fouten.

• Bewaar deze handleiding en verpakking voor toekomstige referentie.

DEUTSCH

Wartun

* Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.

Guía para la seguridad y el buen uso

No utilice este dispositivo cerca de equipo médico.

Tacx bv | Rijksstraatweg 48 | 2241BW | Wassenaar | the Netherlands

ENGLISH

Maintenance

- If necessary, wipe clean with a moist cloth.
- Please do not expose to chemicals.
- Keep away from fire and other heat sources.

The unit will activate when movement is detected. To maximize the transmitter battery lifetime, remove the battery when not used or transported for a longer period. There will be a blinking led when the sensor is activated.

Guide to safety and effective use

• Activate, connect and verify the sensor before and not during a ride or training.

• Do not use this device around medical equipment.

• Do not use this device in places where wireless devices are prohibited.

• The wireless signal could be disturbed under the environment of high voltage or strong magnetic fields.

• This device is not designed for industrial, commercial or medical use.

• Do not leave the sensor exposed in direct sunlight when not in use.

• Do not use sharp objects to replace the battery.

• Do not recharge the batteries.

• Do not damage or puncture the batteries.

• Replace the empty battery with the correct type.

• Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard.

• This product contains a coin battery. If the coin battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

• Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

General

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

General

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

• Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch sind die bereit gestellten

Informationen unverbindlich. Tacx kann für Fehler in diesem Handbuch und deren Folgen keine

Hälfte übernehmen.

ENGLISH

Maintenance

- If necessary, wipe clean with a moist cloth.
- Please do not expose to chemicals.
- Keep away from fire and other heat sources.

The unit will activate when movement is detected. To maximize the transmitter battery lifetime, remove the battery when not used or transported for a longer period. There will be a blinking led when the sensor is activated.

Guide to safety and effective use

• Activate, connect and verify the sensor before and not during a ride or training.

• Do not use this device around medical equipment.

• Do not use this device in places where wireless devices are prohibited.

• The wireless signal could be disturbed under the environment of high voltage or strong magnetic fields.

• This device is not designed for industrial, commercial or medical use.

• Do not leave the sensor exposed in direct sunlight when not in use.

• Do not use sharp objects to replace the battery.

• Do not recharge the batteries.

• Do not damage or puncture the batteries.

• Replace the empty battery with the correct type.

• Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard.

• This product contains a coin battery. If the coin battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

• Keep new and used batteries away from children. If the